

# 検査成績書

Inspection No 第2003013号

1 葉中 1 葉

Any Design  
株式会社 Any Design



Date : 2020/03/31




P/N	ADL-3-005
S/N	-----
temperature	20 [°C]
signature	h=104.1

各測定点における指示値(実測値)は以下の通り。

測定点 [mm/m]	-1.500	-1.200	-0.900	-0.600	-0.300	0.000	+0.300	+0.600	+0.900	+1.200	+1.500
指示値						0.000	0.295	0.595	0.895	1.195	1.490
	-1.490	-1.200	-0.890	-0.605	-0.295	-0.000	0.290	0.595	0.890	1.195	1.485
	-1.490	-1.195	-0.885	-0.600	-0.295	0.000					

[指示誤差]

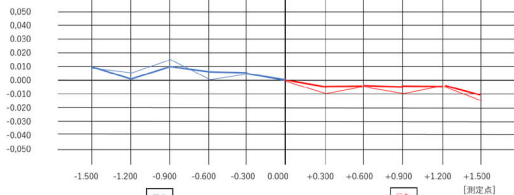

検査法 : 水準器検査機に搭載し指定傾斜を与えた時の指示値。

基準器 : リニアゲージ、分解能0.1 μm(Mitutoyo P/N : LGF-0110L S/N16061878)

基準器校正 : 地方独立行政法人 東京都立産業技術センター(JCSS認定インジケータ検査機)による。

以下余白